


TruSeq Custom Amplicon Kit Dx[®]

Flusso di lavoro e modulo di monitoraggio del kit PER USODIAGNOSTICO IN VITRO

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento all'*Insero della confezione di TruSeq Custom Amplicon Kit Dx* (documento n. 1000000029772).

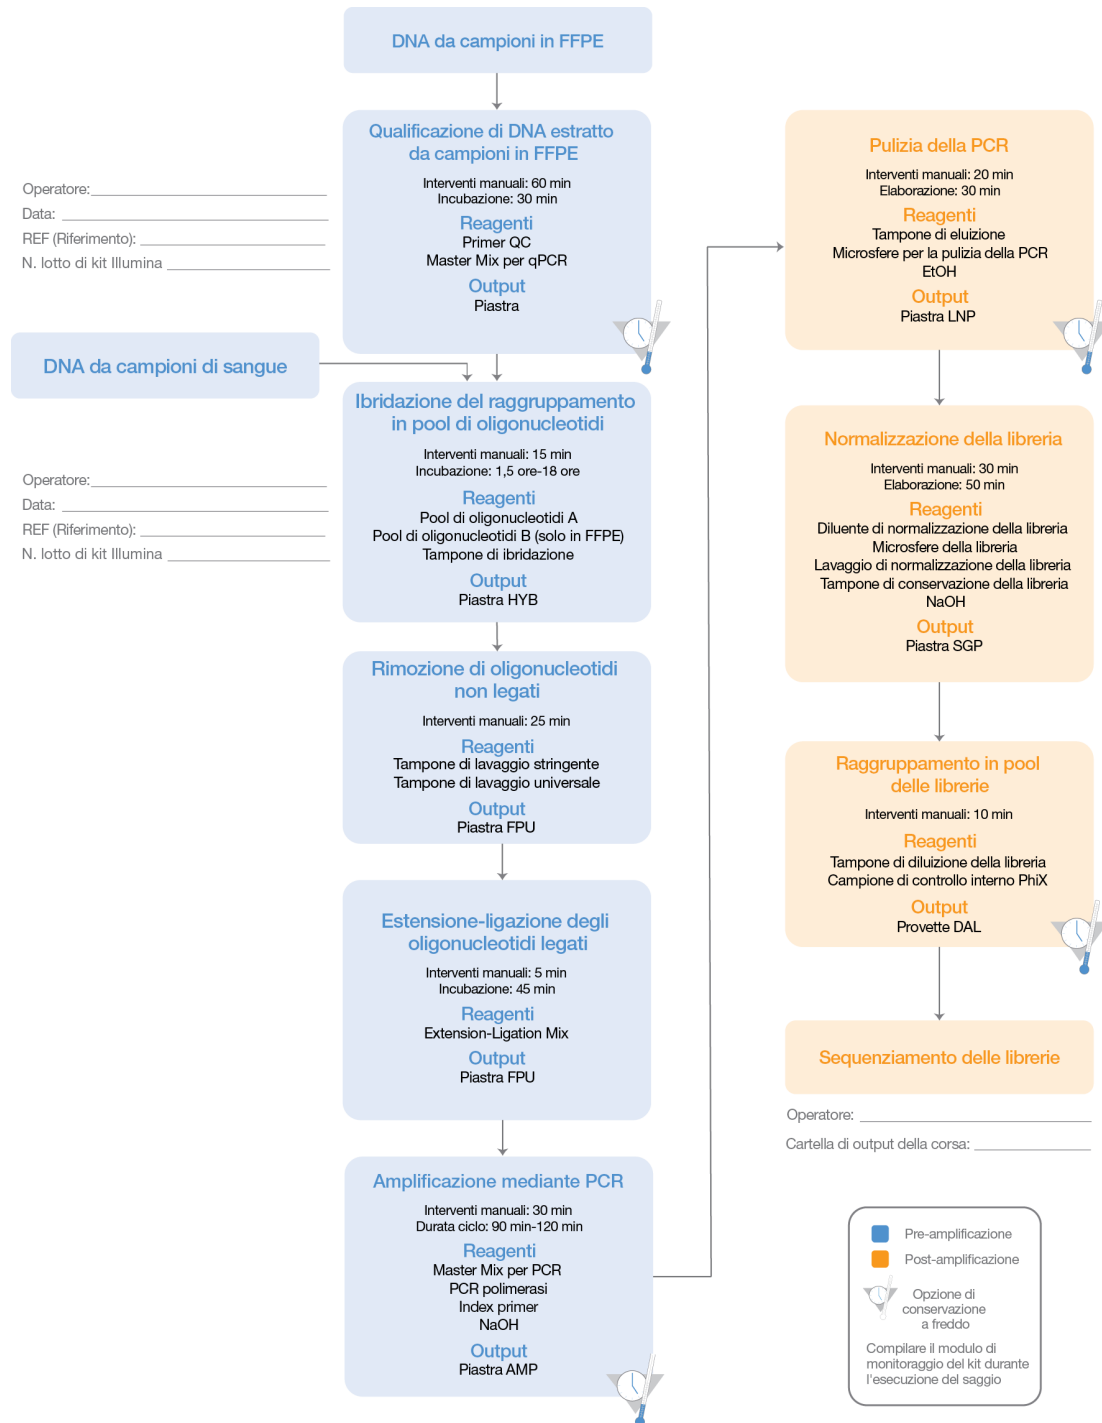


TruSeq Custom Amplicon Kit Dx

Flusso di lavoro e modulo di monitoraggio del kit

[Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota]



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (fuori dal Nord America)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Freddy van Riemsdijkweg 15
5657 EE Eindhoven
Paesi Bassi



Sponsor Australiano:
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australia