


# TruSeq Custom Amplicon Kit Dx<sup>®</sup>

## Workflow- und Kit-Kontrollformular

### FÜR IN-VITRO-DIAGNOSTIK

Ausführliche Anweisungen finden Sie in der *Packungsbeilage zum TruSeq Custom Amplicon Kit Dx* (Dokument-Nr. 1000000029772).

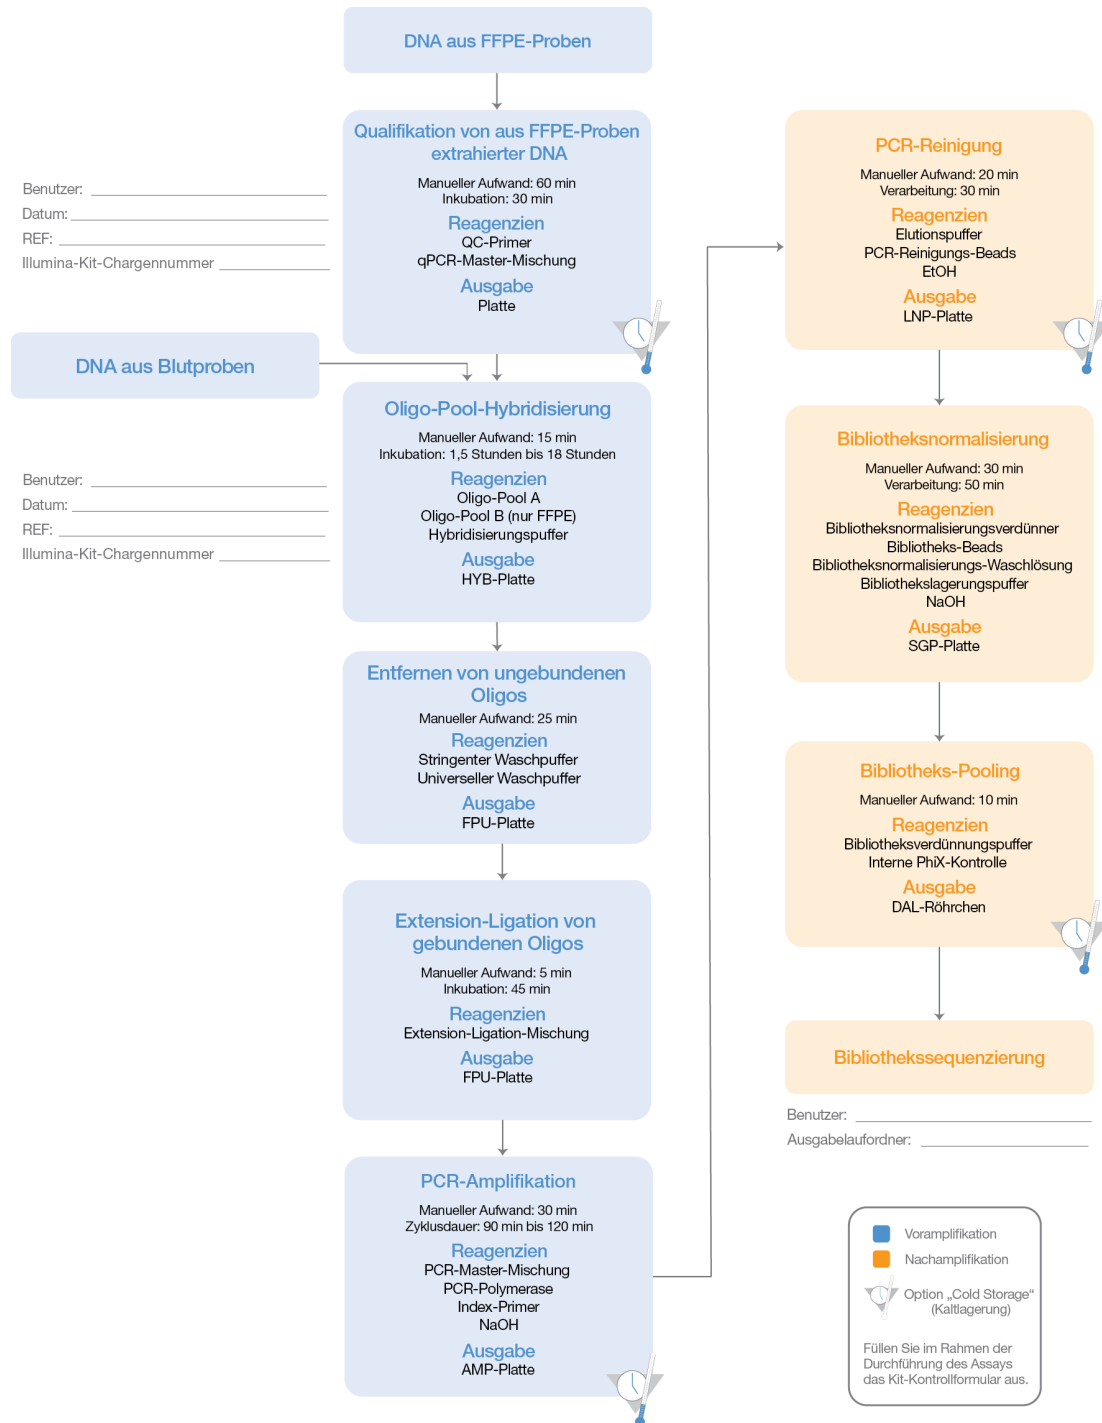


# TruSeq Custom Amplicon Kit Dx

## Workflow- und Kit-Kontrollformular

[Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.]



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, Kalifornien 92122, USA  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (außerhalb von Nordamerika)  
techsupport@illumina.com  
[www.illumina.com](http://www.illumina.com)



Illumina Netherlands B. V.  
Freddy van Riemsdijkweg 15  
5657 EE Eindhoven  
Niederlande



Australische Niederlassung:  
Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Australien