


TruSeq Custom Amplicon Kit Dx[®]

Arbeidsprosess og settsporingsskjema

TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK

Du finner detaljerte instruksjoner i *pakningsvedlegget for TruSeq Custom Amplicon Kit Dx (dokumentnr. 100000029772)*.

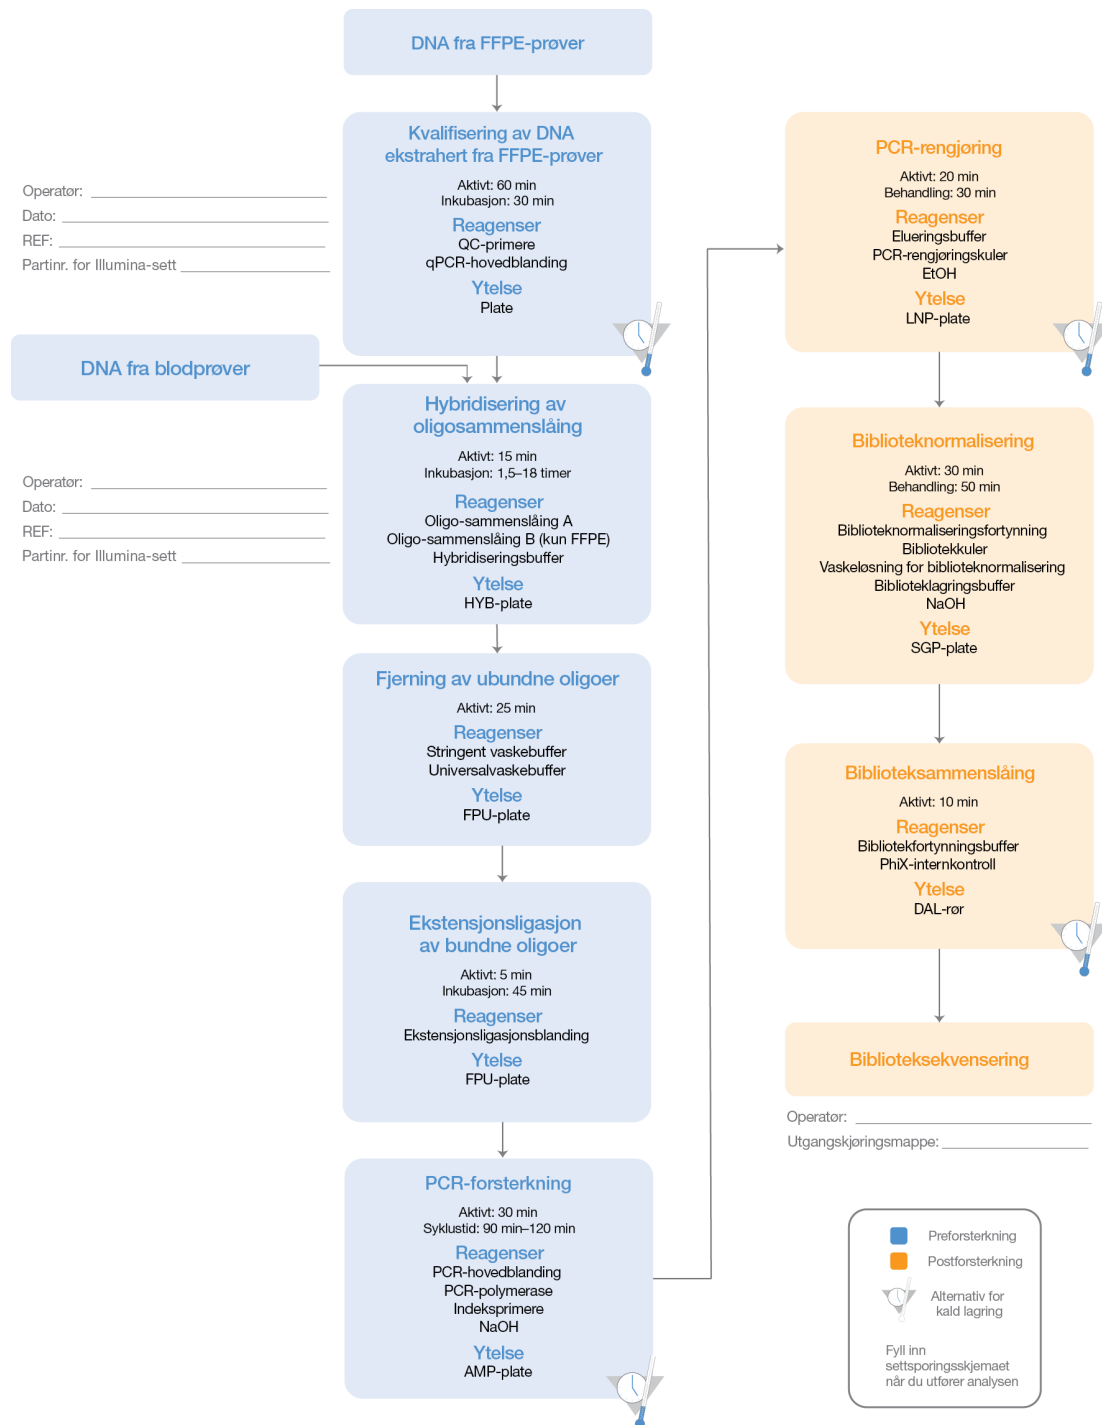

TruSeq Custom Amplicon Kit Dx


Arbeidsprosess og settsporingsskjema

[Denne siden er tom med hensikt]



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 USA
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (utenfor Nord-Amerika)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com

Dokumentnr. 1000000041549 v01 NOR
English Source: 1000000039154 v01
Side 2 av 2



Illumina Netherlands B. V.
Freddy van Riemsdijkweg 15
5657 EE Eindhoven
Nederland



Australsk sponsor:
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australia