


TruSeq Custom Amplicon Kit Dx[®]

Spåringsformulär för arbetsflöde och kit FÖR IN VITRODIAGNOSTISKT BRUK

Detaljerade anvisningar finns i *Bipacksedel till TruSeq Custom Amplicon Kit Dx (dokumentnr 100000029772)*.

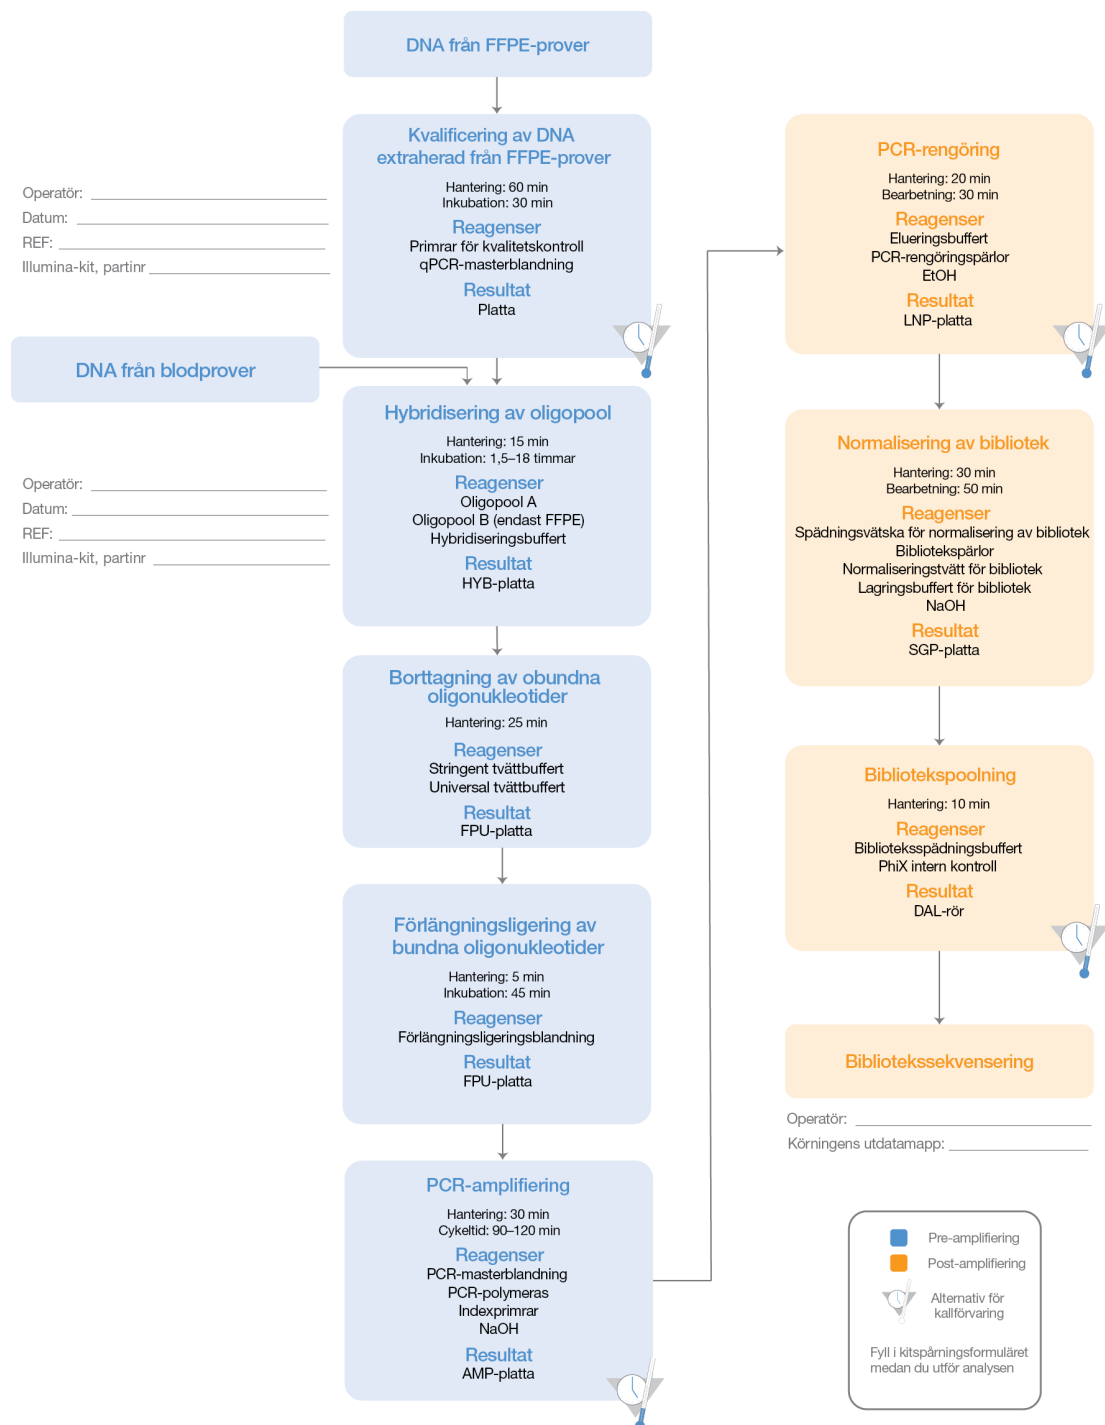

TruSeq Custom Amplicon Kit Dx


Spåringsformulär för arbetsflöde och kit

[Den här sidan har avsiktligt lämnats tom]



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 USA
+1 800 809 ILMN (4566)
+1 858 202 4566 (utanför Nordamerika)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com

Dokumentnr 1000000072472 v01 SWE
English Source: 1000000039154 v01
Sidan 2 av 2



Illumina Netherlands B.V.
Freddy van Riemsdijkweg 15
5657 EE Eindhoven
Nederländerna



Australisk sponsor:
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australien