


Kit Dx do amplicon personalizado TruSeq®

Formulário de rastreamento do fluxo de trabalho e do kit PARA UTILIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO *IN VITRO*

Para obter instruções detalhadas, consulte o folheto informativo do *kit Dx do amplicon personalizado TruSeq* (documento nº 100000029772).

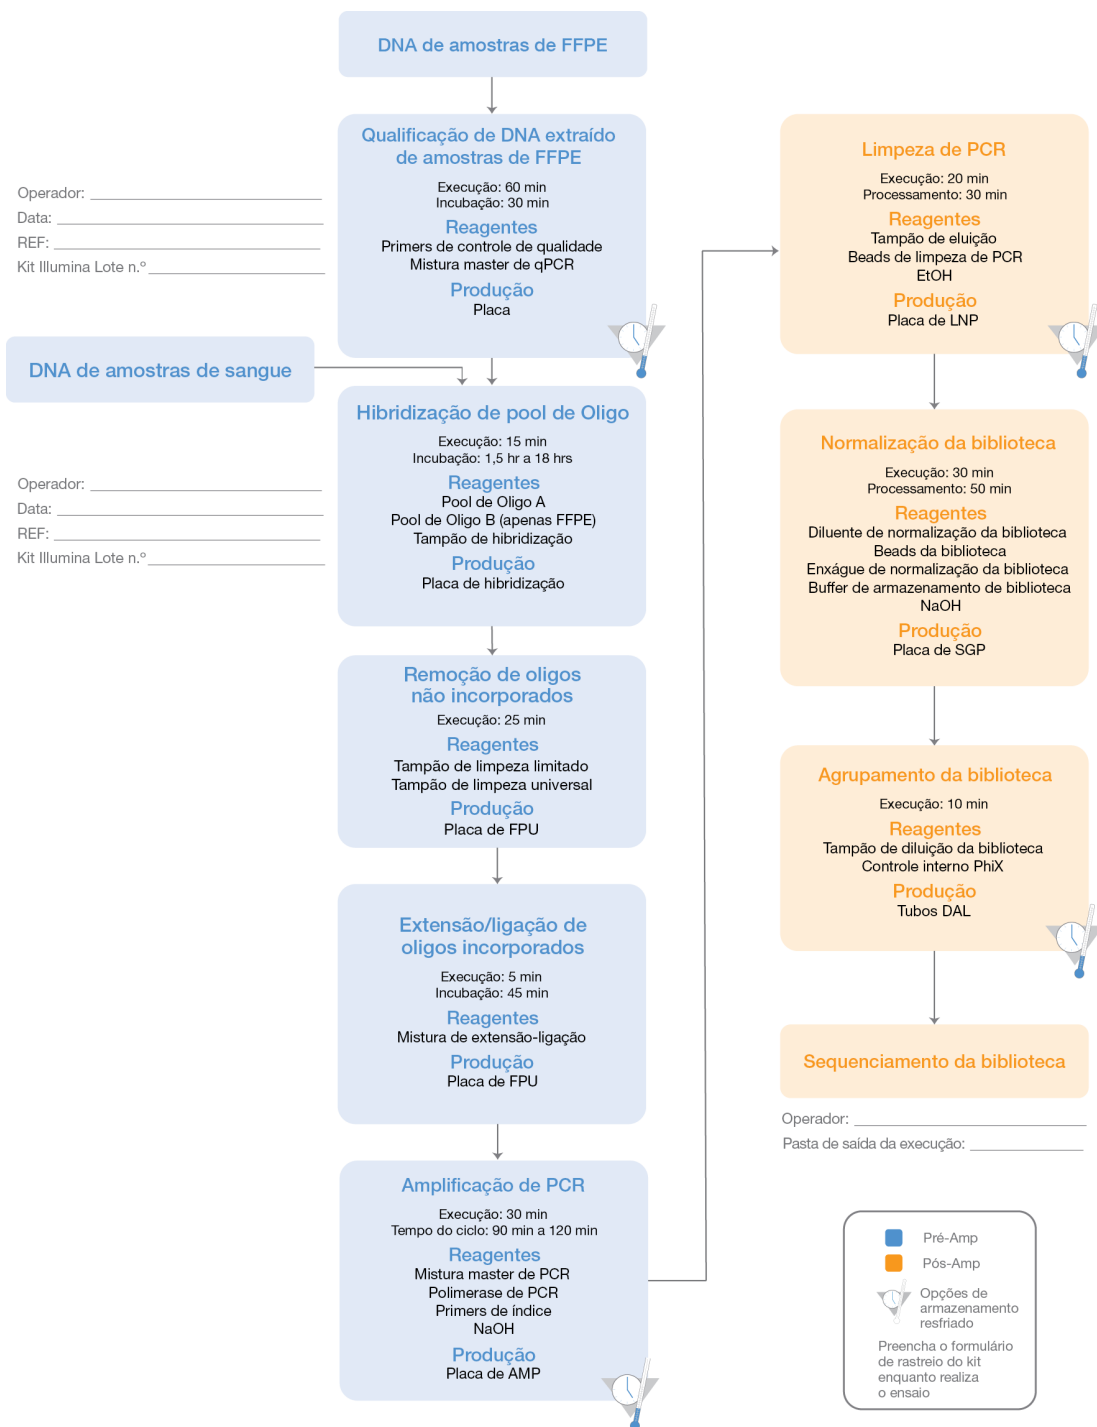


Kit Dx do amplicon personalizado TruSeq

Formulário de rastreamento do fluxo de trabalho e do kit

[Esta página foi intencionalmente deixada em branco]



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Califórnia 92122, EUA
+1 (800) 809-ILMN (4566)
+1 (858) 202-4566 (fora da América do Norte)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Freddy van Riemsdijkweg 15
5657 EE Eindhoven
Países Baixos



Patrocinador australiano:
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Austrália